



# Test biegłości laboratoryjnej w UE

## Wskaźnik niepowodzenia testu w uczestniczących laboratoriach

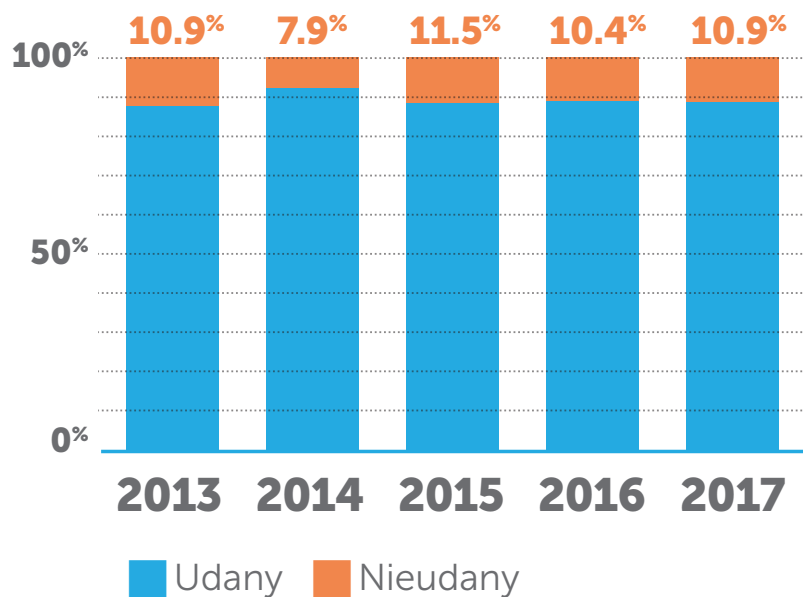

## Błąd testowy według parametru (najczęściej)

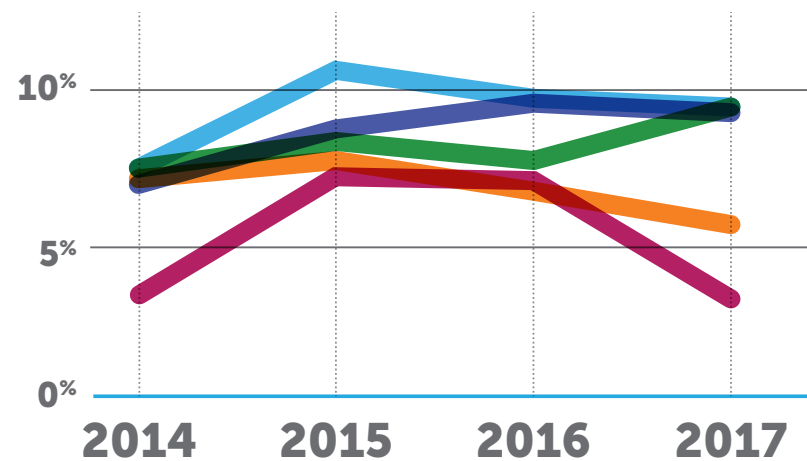

### Parametr:

- Azot całkowity
- Fosfor ogólny
- Azot azotanowy
- Azot amonowy
- ChZT

Source, University of Stuttgart, <http://www.iswa.uni-stuttgart.de/ch/aqs/>



Be Right™